


28.09.2020 Wzorcowanie pirometrów radiacyjnych

Autor : Grażyna Andreskowska
Opublikowane przez : Magdalena Olejnik

Laboratorium Długości i Termometrii OUM wykonuje wzorcowania pirometrów radiacyjnych w zakresie temperatur od - 15 °C do + 500 °C ...

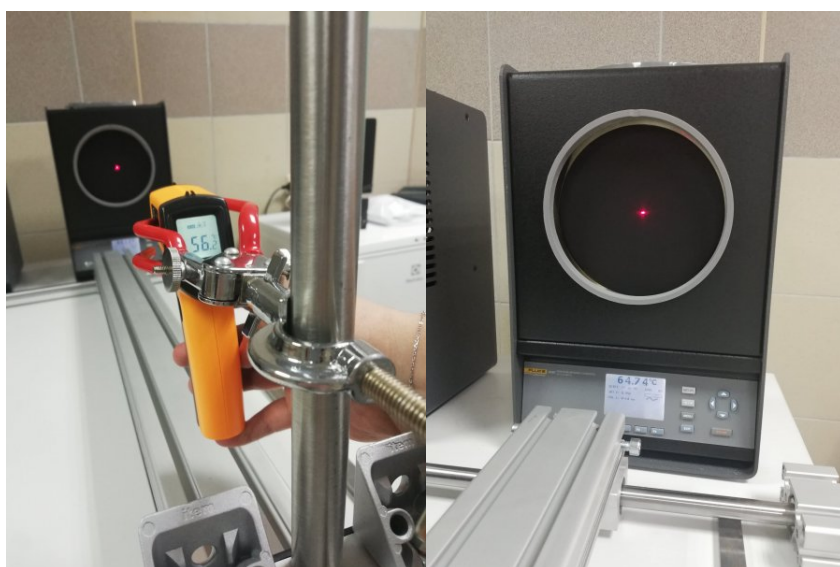

Stanowisko do wzorcowania pirometrów

Stanowisko do wzorcowania pirometrów_1

Laboratorium Długości i Termometrii OUM wykonuje wzorcowania pirometrów radiacyjnych w zakresie temperatur od - 15 °C do + 500 °C, przy współczynniku emisyjności $\varepsilon=(0,9 \div 1,0)$. Realizowane są one na stanowisku pomiarowym, którego głównymi elementami składowymi są wysokiej klasy dokładności kalibratory podczerwieni, pracujące w paśmie spektralnym od 8 μm do 14 μm .

Wzorcowania realizowane są w ramach posiadanej akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (Nr AP 088).